

OSTEO pro スマート

超音波骨密度測定システム

患者情報



患者ID: 2019052424
名前: a
生年月日: 1940/09/10

年齢: 78
性別: 男性
測定足(右側/左側): 右側

測定結果

測定日: 2019/05/24

測定番号: 1/1

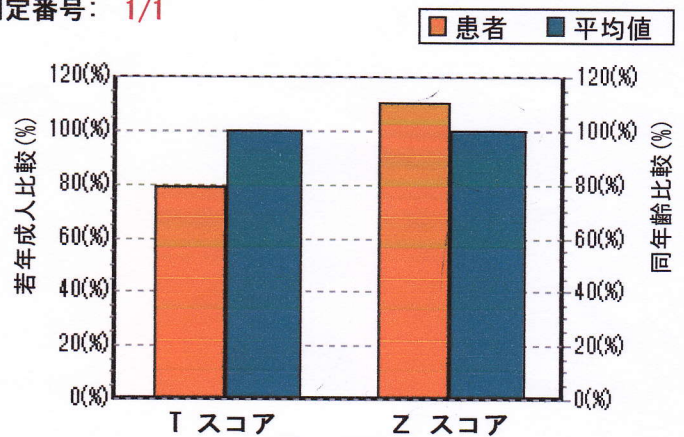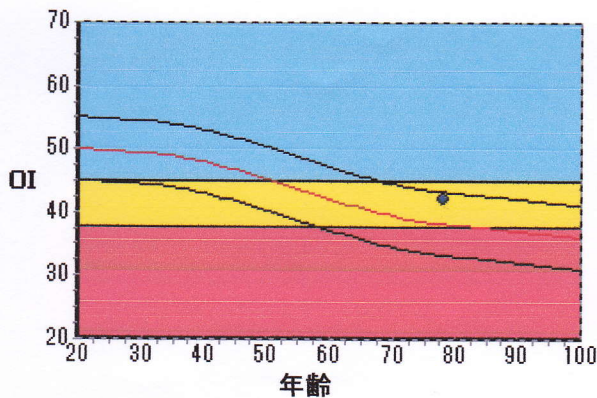

参照データベース: アジア

骨粗鬆症指数: 42.2

超音波伝播速度: 1344.1 m/s

T スコア: -1.58 (若年齢標準偏差比較値)



Z スコア: 0.80 (同年齢標準偏差比較値)

若年成人比較(%): 79.2 %

同年齢比較(%): 110.5 %

骨粗鬆症進行度評価点(%): N/A %

分析結果

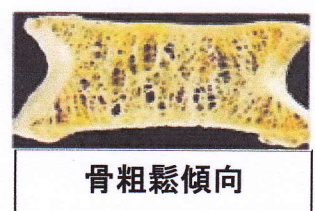

コメント

施設名:

住所:

担当者:

電話番号: